


CareStart™ COVID-19 Antigen Home Test


USER INSTRUCTIONS

You must follow the test directions carefully to get an accurate result.
Visit accessbio.net to obtain the complete instructions for use.
FOR USE UNDER EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) ONLY.


IMPORTANT: Swabbing the nostrils is critical for obtaining an accurate result. If you do not swab your nose, the device will produce a false negative result.

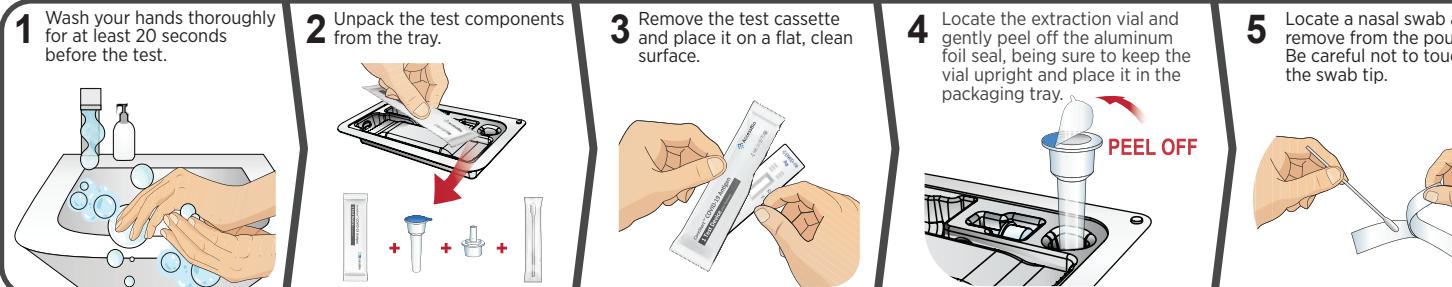

6 Gently insert the swab no more than 3/4 inch into the **LEFT** nostril. Then, slowly rotate the swab at least **5 times** in a circular path for a total of **15 seconds**. If you have questions, see the CDC Guidelines.

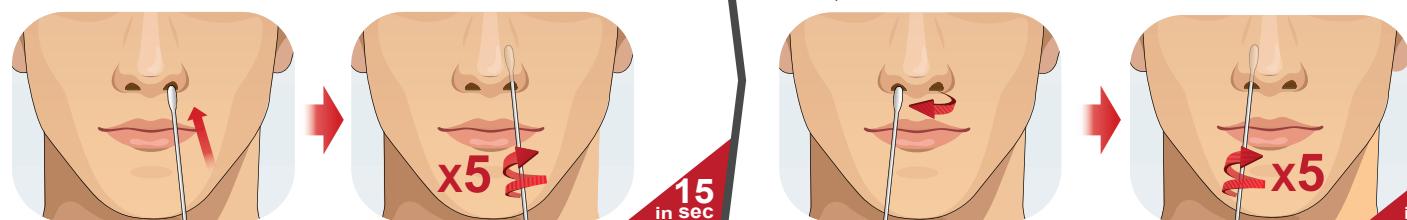

8 Place the swab into the extraction vial. Rotate the swab vigorously at least **5 times**.

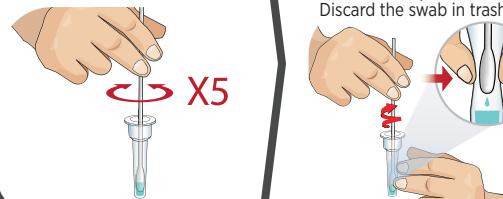

9 Remove the swab by rotating against the extraction vial while squeezing the sides of the vial to release the liquid from the swab. Discard the swab in trash.




10 Close the vial by pushing the cap firmly onto the vial.



11 With your finger, mix thoroughly by flicking the bottom of the vial.



12 Invert the extraction vial and hold the sample vertically above the sample well. Squeeze the vial gently. Allow **THREE (3)** drops of sample to fall into the sample well.

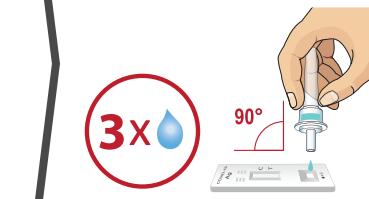

13 Start a timer. Read the result at **10 minutes**. The test result should not be read after 15 minutes.

**Disposal**

Dispose of all used test kit components and swab samples in household trash.

**Using Mobile Application**

Please start the test and follow the in-app step-by-step test instructions.

1. Download and open App, On/Go™ Mobile Application
Download the App on the App Store or Google Play Store. Ensure you are connected to the internet during your test.

2. Answer a few questions in the App


3. Watch the instructional video.

4. Follow step-by-step instructions for your test.

5. Test result

The App will assist in your visual result interpretation. Please follow the instructions provided in the App. You will be required to take a picture of the test device, and then look at the test cassette and answer questions about the result interpretation.

Scan the QR code to download

**Results Interpretation**

Make sure you wait the full 10 minutes.

You will be able to interpret your test results by following the in-app interpretation instructions or those provided below.

NOTE: The test results should be read by visual and interpreted at 10 minutes after the sample application and interpretation of the results should not exceed 15 minutes as it may yield inaccurate results.

COVID-19 Detected (Positive)

One purple-colored line next to "C" and one blue-colored line next to "T" indicates COVID-19 positive result.



IMPORTANT Look very closely! The color intensity in the test region will vary. Any faint colored line in the test region should be considered as positive.

A positive test result indicates that antigens from SARS-CoV-2 were detected, and the patient is very likely to be infected with the virus and presumed to be contagious. Test results should always be considered in the context of clinical observations and epidemiological data in making a final diagnosis and patient management decisions. You should self-isolate at home and avoid contact with others as per CDC recommendations to avoid spreading the virus to others.

Invalid
Invalid barcode or absence of a purple-colored line next to "C".

Re-test with a COVID-19 test may be needed.

An invalid test result indicates that your test has experienced an error and is unable to interpret the result of the test. You will need to re-test with a new test or consult a healthcare professional. If you still have symptoms, you should self-isolate at home and avoid contact with others prior to the retest.

COVID-19 Not Detected (Negative)

One purple-colored line only next to "C" indicates a negative result.



Re-test in 24-48 hours if your first test result is negative.

A negative test result indicates that antigens from SARS-CoV-2 were not detected from the specimen. However, a negative result does not rule out COVID-19 and should not be used as the sole basis for treatment or patient management decisions, including infection control decisions. Negative results should be considered in the context of an individual's recent exposures, history, and the presence of clinical signs and symptoms consistent with COVID-19 and confirmed with a molecular assay, if necessary, for patient management.

Prueba domiciliaria CareStart™ COVID-19 Antigen


INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

! Debe seguir cuidadosamente las instrucciones de la prueba para obtener un resultado preciso. Visite accessbio.net para obtener instrucciones de uso completas.
SOLO PARA USO CON LA AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA (EUA).


IMPORTANTE: Hisopar las fosas nasales es fundamental para obtener un resultado preciso. Si no se hisopa la nariz, el dispositivo generará un resultado falso negativo.




6 Inserte suavemente el hisopo no más de 3/4 pulgadas en la fosa nasal **IZQUIERDA**. Luego, gire el hisopo lentamente al menos **5 veces** de manera circular durante un total de **15 segundos**. Si tiene preguntas, consulte las pautas del CDC.

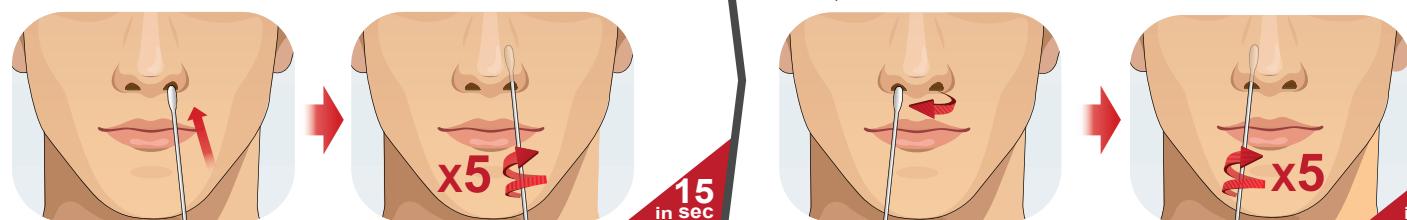

7 Quite suavemente el hisopo de la fosa nasal **DERECHA**, y repita el proceso de rotar al menos **5 veces** de manera circular durante al menos **15 segundos**. Quite el hisopo de la fosa nasal **DERECHA**.

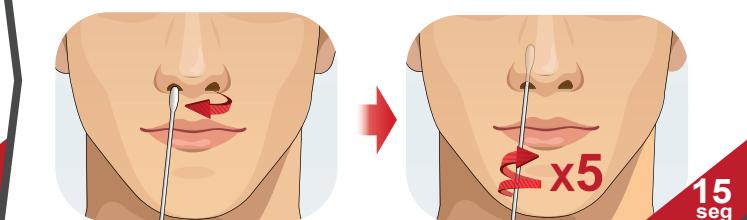

8 Coloque el hisopo en el vial de extracción. Gírelo energéticamente al menos **5 veces**.

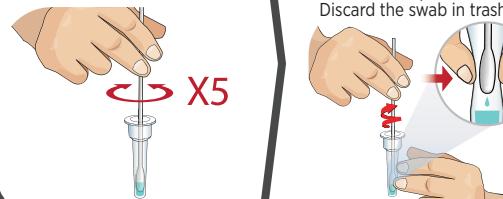

9 Retire el hisopo al girarlo contra el vial de extracción mientras aprieta los lados del vial para liberar el líquido del hisopo. Descarte el hisopo en la basura.




10 Cierre el vial al colocar la tapa firmemente en el vial.




11 Con el dedo, mezcle bien al golpear la parte inferior del vial.



12 Invierte el vial de extracción y sostenga la muestra verticalmente por encima del pocillo de la muestra. Apriete el vial suavemente. Deje caer **TRES (3)** gotas de la muestra en el pocillo de la muestra.

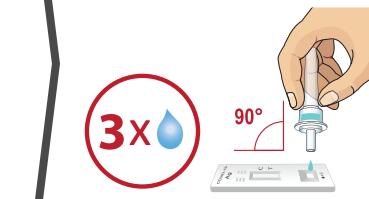

13 Inicie un temporizador. Lea el resultado a los **10 minutos**. El resultado de la prueba no debe interpretarse pasados los 15 minutos.

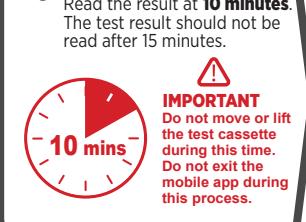**Desecho**

Deseche todos los componentes del kit de prueba utilizados y las muestras del hisopado en el bote de basura de su casa.

Usar la aplicación móvil

Asegúrese de tener conexión a Internet y descargue la aplicación antes de comenzar la prueba.

Importante

No mueva ni levante el casete de la prueba durante este tiempo. No salga de la aplicación móvil durante este proceso.



Para comenzar la prueba, siga las instrucciones paso a paso y a su propio ritmo de la aplicación.

1. Descargue y abra la aplicación, On/Go™ Mobile Application



Descargue la aplicación del App Store o del Google Play Store.

Asegúrese de estar conectado a Internet durante la prueba.

2. Responda algunas preguntas en la aplicación

3. Mire el video instructivo.

4. Siga las instrucciones paso a paso de la prueba.

5. Resultado de pruebas

La aplicación lo ayudará con la interpretación visual de los resultados. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación. Se le pedirá que tome una imagen del dispositivo de prueba y luego observe el casete de la prueba y responda las preguntas sobre la interpretación de resultados.

Interpretación de los resultados

Make sure you wait the full 10 minutes.

You will be able to interpret your test results by following the in-app interpretation instructions or those provided below.

NOTE: The test results should be read by visual and interpreted at 10 minutes after the sample application and interpretation of the results should not exceed 15 minutes as it may yield inaccurate results.

COVID-19 detectado (positivo)

Una línea púrpura junto a una "C" y una línea azul junto a una "T" indican un resultado positivo por COVID-19.



IMPORTANT ¡Mire bien de cerca! La intensidad de color en la región de prueba varía. Todas las líneas de color tenues en las regiones de prueba deben considerarse positivas.

Interpretación de los resultados

Asegúrese de esperar los 10 minutos completos.

Podrá interpretar los resultados de la prueba siguiendo las instrucciones de interpretación de la aplicación o aquellas que se proporcionan a continuación.

COVID-19 no detectado (negativo)

Una sola línea púrpura junto a una "C" indica un resultado negativo.



Vuelva a analizar en 24 a 48 horas si el primer resultado de la prueba es negativo.

Un resultado negativo de la prueba indica que los antígenos del SARS-CoV-2 no se detectaron en la muestra. Sin embargo, un resultado negativo no descarta el COVID-19 y no debe considerarse como el único fundamento para el tratamiento o la toma de decisiones sobre el manejo de los pacientes, incluidas las decisiones relativas al control de la infección. Los resultados negativos deben considerarse en el contexto de las exposiciones recientes, los antecedentes y la presencia de signos y síntomas clínicos de la persona que sean consistentes con COVID-19, y confirmados con un ensayo molecular, si fuese necesario, para el manejo del paciente.

Inválido

Código de barras inválido o ausencia de una línea de color púrpura junto a una "C".



Es posible que sea necesario volver a analizar con una prueba de COVID-19. Un resultado de prueba inválido indica que la prueba ha arrojado un error y no se pudo interpretar el resultado de la prueba. Tendrá que volver a realizar una nueva prueba o consultar a un profesional de atención médica. Si aún tiene síntomas, debe aislarse en casa y evitar el contacto con los demás antes de volver a realizar la prueba.

